

ALTAIR® 4X

Detector Multigas

PARA ENCENDERLO

Encienda el instrumento con el botón de . El instrumento se calentará y mostrará la información. Ajuste de Aire Fresco (FAS, por sus siglas en inglés): para aceptar, presione ; para cancelar, presione .

¿CÓMO REALIZAR UNA VERIFICACIÓN (BUMP TEST)?

1 Rápidamente confirme que los sensores de gas estén funcionando. Mientras el instrumento esté encendido en aire limpio y fresco, verifique que las lecturas no muestren la presencia de gas. La lectura del oxígeno debe ser de 20.8%. No debe haber gas tóxico ni combustible en el ambiente.

2 Desde la pantalla de medidas, presione para mostrar ¿VERIFICACIÓN (BUMP TEST)?



3 Sujete la tapa de calibración.



A. Inserte la lengüeta de la tapa de calibración en la ranura del instrumento; presione la tapa hasta que quede fija.



B. Presione ambos lados de las lengüetas hasta que encajen.




C. Conecte un extremo del tubo a la tapa de calibración; conecte el otro extremo del tubo al regulador del cilindro.


4 Verifique que las concentraciones mostradas coincidan con el cilindro de gas. De lo contrario, ajuste los valores a través del menú de ajuste de calibración tal y como se describe en el manual de operación, o utilice el cilindro de gas adecuado.



A. Presione el botón para iniciar la Verificación (Bump Test), después abra la válvula reguladora. El reloj de arena comenzará a parpadear y los sensores responderán al gas.

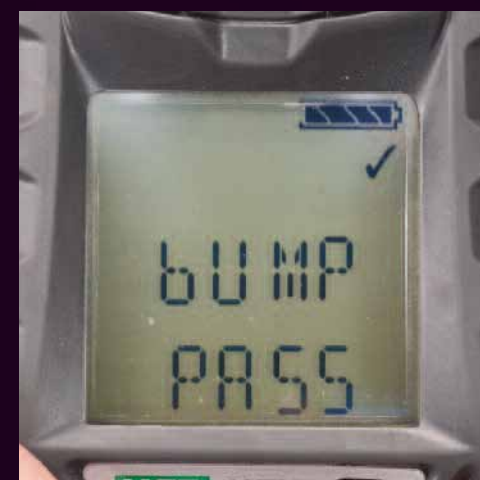

B. Una vez que la Verificación (Bump Test) esté completa, el instrumento instantáneamente mostrará BUMP PASS o BUMP ERROR junto con la etiqueta de cualquier sensor que haya fallado, antes de regresar a la pantalla de medidas.

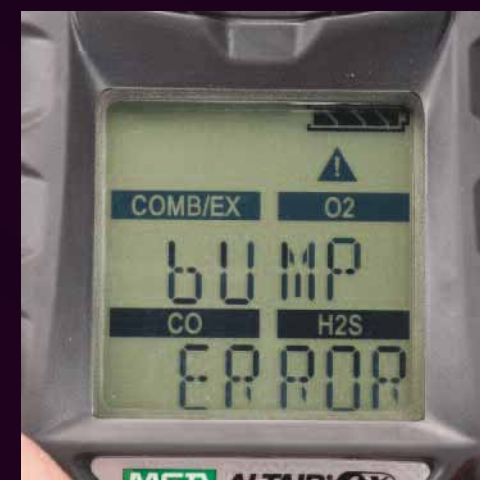

C. Si el instrumento no pasa la Verificación (Bump Test), lleve a cabo la calibración conforme al manual de operación.

D. Una vez que pase la Verificación (Bump Test), aparecerá el símbolo en la pantalla de medidas durante 24 horas.*

*MSA recomienda realizar la Verificación (Bump Test) de los detectores de gas portátil siempre antes de su uso. Si el detector no pasa la Verificación (Bump Test) deberá realizar la calibración antes de seguir utilizándolo.

PARA APAGARLO

Apague el instrumento presionando el botón durante varios segundos.

Para mayor información, favor de consultar el manual de Operación del Detector Multigas ALTAIR 4X.

www.MSAafety.com

